

PRATIKA BABY B

M9010/34/8

reverberi

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001 & EN 13485



Reverberi Arnaldo S.r.l.


Via Don Luigi Sturzo n°6 42021 BARCO (Reggio Emilia) ITALY

Tel. 0039 0522/875159 Fax. 0039 0522/875579

reverberisrl@gmail.com www.reverberisrl.com

Autoclave a vapore portatile da laboratorio

Portable laboratory steam autoclave

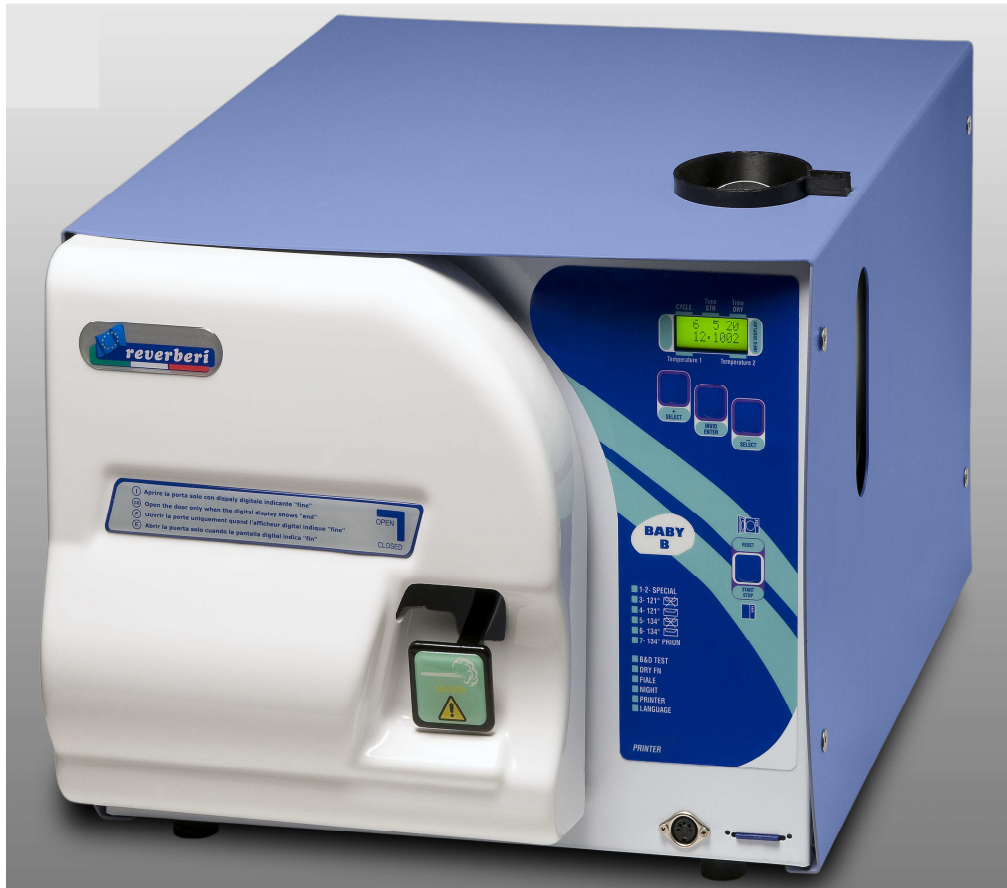

**Con SD Card
integrata**

**SD Card
Integrated**




CICLO FRAZIONATO

- 1- tempo di equilibrio con vuoto
- 2- sterilizzazione e mantenimento della T°
- 3- asciugatura
- 4- mantenimento
- A- chiusura porta
- B,C,D,E,F- vuoto frazionato a 3 picchi
- G- verifica pressione a 0,9 bar
- H- inizio sterilizzazione
- I- controllo costante della sterilizzazione
- L- scarico ed inizio asciugatura
- M- fine ciclo e inizio mantenimento
- N- depressione termodinamica e asciugatura

FRACTIONATED CYCLE

- 1- balancing time with vacuum
- 2- sterilizing and T° upkeep
- 3- drying
- 4- upkeep
- A- door closing
- B,C,D,E,F- fractionated vacuum with 3 peaks
- G- 0.9 bar pressure check
- H- sterilizing begins
- I- constant monitoring of sterilizing process
- L- draining and start of drying phase
- M- end of cycle and start of upkeep phase
- N- thermodynamic vacuum and drying

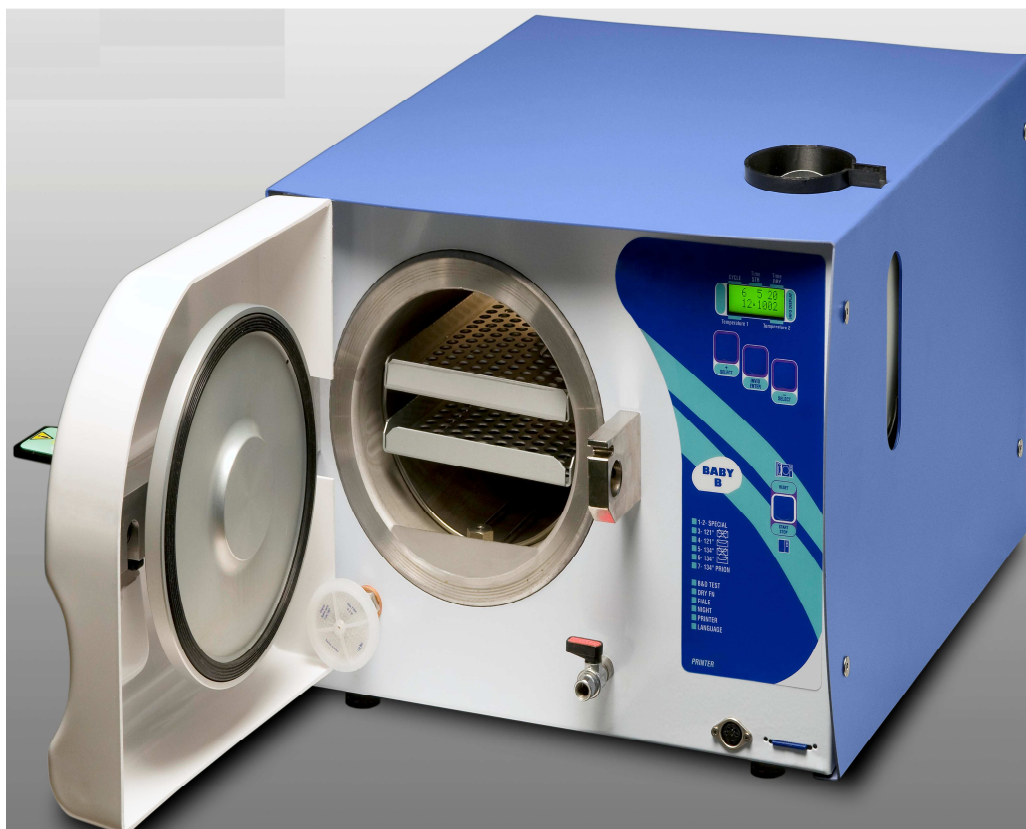

info display

info display

selezione programmi
invio dati
selezione programmi

programs selection
enter data
programs selection

1- cicli speciali
2- rapido 121°
3- imbustato 121°
4- rapido 134°
5- imbustato 134°
6- ciclo prione
7- test B & D
8- vacuum test
9- asciugatura supplementare
10- test spore®
11- ora
12- data
13- partenza ritardata
14- cicli B
15- ciclo notte
16- selezione stampanti
17- selezione multilingue
18- numero cicli
19- sterilizzazione liquidi

special cycles
quick 121°
packed 121°
quick 134°
packed 134°
prion's cycle
Bowie & Dick test
vacuum test
supplementary drying
spore® test
time
date
delayed starting
B cycles
night cycles
printers selection
multilingual selection
cycles number
liquid sterilization

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL FEATURES	
ALIMENTAZIONE	230 V. 50 /60 Hz	POWER SUPPLY	230 V. ca +/- 10%
POTENZA	1200w	POWER	1200w
TANICA DI SCARICO	Esterna	WATER TANK	External
DIMENSIONI CAMERA	Ø165 x L = 290 (7 lt.) Inox	CHAMBER DIMENSIONS	Ø165 x L = 290 (7 lt.) Stainless Steel
DIMENSIONI (LxPxH)	41x60x33 cm	DIMENSIONS (WxDxH)	41x60x33 cm
DISPLAY	16 Cifre	DISPLAY	16 Digits
TEMPO DI STERILIZZAZIONE	0-30 min.	STERILIZATION TIME	0-30 min.
TEMPERATURA STERILIZZAZIONE	121° - 134°	STERILIZATION TEMPERATURE	121° - 134°
AVVISO SONORO	Di fine Ciclo	ACOUSTIC INDICATOR	End of cycle
TANICA RISERVA ACQUA	4 Litri	RESERV WATER TANK	4 Liters
POMPA ACQUA ENTRATA CAMERA	Si	WATER PUMP CHAMBER ENTRANCE	Yes

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	MAIN FEATURES
Ciclo di asciugatura supplementare	Supplementary drying cycle
Ciclo test per verifica spore	Spores test cycle
Ciclo rapido	Fast cycle
Cicli programmabili	Programmable cycles
Programma auto diagnosi	Self-diagnostic program
Camera inox 7 lt.	Inox chamber 7lt.
Due vassoi in alluminio	Two alluminium trays
Entrata acqua automatica con pompa	Automatic water inlet pump
Avviso sonoro fine ciclo	End-of-cycle with acoustic indicator
Vuoto tramite pompa	Vacuum pump

